

SFD-100MJ 系列便携式可燃/有毒气体检测仪

# 产品说明书



深圳市索福达电子有限公司



## 目录

一、概述	2
三、技术参数:	5
四、外型图	7
五、按键定义及操作说明	8
六、开机启动说明	8
七、菜单操作说明	10
7.1 零点校准操作说明	10
7.2 浓度校准操作说明	12
7.3 恢复出厂操作说明	14
7.4 数据记录操作说明	15
7.5 报警设置操作说明	17
7.6 系统设置操作说明	20
7.7 单位设置操作说明	24
7.8 其它设置操作说明	25
7.9 本机信息说明	27
八、常见故障及解决对策	28
九、设备维护	31
十、注意事项	32
十一、其它可选配的传感器技术性能及参数表	33

## 一、概述

便携式气体检测仪用于：快速检测多种气体浓度及环境温湿度测量，测量超过限值则发出声光振动报警。采用 2.31 寸高清彩屏实时显示，采用行业知名品牌的气体传感器，主要检测原理有：电化学、红外、催化燃烧、热导、PID 光离子等。先进的电路设计、成熟的内核算法处理，独特的外形设计，取得了多项软件著作和外观等专利。适用于检测管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度；气体泄漏或各种背景气体为氮气或氧气的高浓度单一气体纯度。检测气体种类超过 500 余种。

## 二、产品特点

### ★可以同时检测 1~4 种气体，单位自由切换

单位可选：PPM、mg/m<sup>3</sup>、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L。

★内置泵吸式测量，集成水汽、粉尘过滤器，防止因水汽和粉尘损坏传感器和仪器，可用于高湿度、高粉尘环境响应迅速；特殊气路设计，采样距离大于 10 米，可直接检测负压或正压-0.5~2 公斤的气体。

### ★丰富的人机界面

2.31 寸高清彩屏，显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储等信息；菜单界面采用高清仿真图形显示各个菜单的功能名称。

**★大容量数据存储功能（容量可定制），支持多种存储方式，选配 RS485 通讯**

标配 10 万条数据存储容量；支持实时存储、定时存储，或只存报警浓度数据；支持本机查看、删除数据，和通过 USB 接口上传到电脑进行数据分析或打印。

**★高温气体检测（选配）**

选配高温采样降温过滤手柄或高温高湿预处理系统可检测 400 度温度的烟气。更高温度的气体检测可订制。

**★三种显示模式可切换**

同时显示四种气体浓度，大字体循环显示单通道气体的浓度，实时曲线显示。

**★图形化显示，以曲线形式反映一段时间内气体浓度变化走势**

- 数据恢复功能，如遇误操作可以选择部分或全部恢复
- 可设置是否显示最大值、最小值、平均值
- 标准 USB 充电接口，具有充电保护功能，支持 USB 热插拔，充电状态仪器可正常工作
- 采用 4600mA 大容量可充电高分子聚合物电池，可长时间连续工作
- 高精度温湿度测量（选配）
- 支持实时检测或定时检测，不检测时可以把泵关闭以延长开机时间
- 多种报警方式，报警时多方位立体指示报警状态

包含声光报警、振动报警、显示屏视觉报警。

报警种类包含：浓度报警、欠压报警、故障报警。

- 多种报警模式设置：低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警
- 误操作识别功能：浓度校准误操作自动识别并阻止，能避免人为因素造成的不良
- 零点自动跟踪，长期使用不受零点漂移影响
- 目标点多级校准，保证测量的线性度和精度
- 中英文界面可选择
- 宽工作温度：-40~+70℃，支持温度补偿
- 日志记录

记录校准日志、维修日志、故障解决对策，传感器寿命到期提醒，下次浓度校准时间提醒功能。

- 满足本安电路设计要求，抗静电，抗电磁干扰。
- 防护等级达 IP65，防水溅、防尘、防爆、防震。

### 三、技术参数：

检测气体	有毒气体、氧气、二氧化碳、易燃易爆类气体、TVOC 等， 1~4 种气体随意组合。 选配：温湿度测量。				
应用场合	石油、化工、医药、环保、燃气配送、仓储、烟气分析、 空气治理等所有需要便携式快速检测气体浓度的场合。				
检测范围	0~1、10、100、1000、5000、50000、100000ppm、200 毫克/升、100%LEL、20%、50%、100%Vol 可选，其他量 程可订制。				
分辨率	0.01ppm 或 0.001ppm (0~10 ppm); 0.01ppm (0~100 ppm), 0.1ppm (0~1000 ppm), 1ppm (0~1000 ppm 以上), 0.01 毫克/升 (0~200毫克/升)、 0.1%LEL、 0.01%Vol、 0.001%Vol。				
检测原理	电化学、催化燃烧、红外、热导、PID 光离子等，根据 气体类型、量程、现场环境和用户需求而定。				
传感器寿命	电化学原理 2~3 年，氧气 2 年或 6 年可选，红外原理 5~ 10 年，催化燃烧 3 年，热导 5 年，PID 光离子 2~3 年。				
最大允许 误差值	≤±3%F.S (更高精度可订制)				
线性度	≤±2%	重 复 性	≤±2%	不 确 定 度	≤±2%
响应时间	T90≤30 秒			恢 复 时 间	≤30 秒
工作环境	温度：-40℃~+70℃，湿度：≤10~95%RH，内置过滤 器可在高湿度或高粉尘环境使用				
样气温度	-40℃~+70℃，选配高温采样降温过滤手柄，可检测 400 度或更高温度的烟气浓度				

## SFD-100MJ 系列便携式可燃/有毒气体检测仪产品说明书

<b>温湿度测量</b>	选配：温度-40℃~+70℃，精度 0.5℃；湿度 0~100%RH，精度 3%RH
<b>工作电源</b>	3.6VDC，4500mA 大容量可充电高分子聚合物电池
<b>显示方式</b>	2.31 寸高清彩屏
<b>检测方式</b>	内置泵吸式测量，流量 500 毫升/分钟。标定流量要大于 500 毫升/分钟，要接三通管进行分流，保证有多余的气体从旁路排出
<b>报警方式</b>	声光报警、振动报警、声光+振动报警、关闭报警可设
<b>通讯接口</b>	USB（充电与通讯），选配 RS485 通讯接口
<b>数据存储</b>	标配 10 万条数据存储容量
<b>防护等级</b>	IP65
<b>防爆类型</b>	本质安全型
<b>防爆标志</b>	Exia II CT6
<b>外型尺寸</b>	160×70×28mm(L×W×H)
<b>重 量</b>	300g
<b>标准附件</b>	说明书、合格证、保修卡、USB 充电器（含数据线）、高档铝合金仪器箱、背夹、湿度粉尘过滤器
<b>选配项</b>	温湿度测量功能、1.2 m 可伸缩采样手柄（1-10 米软管，标准长度 1 米）、0.4 米不锈钢采样手柄（带粉尘过滤器，不可伸缩）、高温采样降温过滤手柄、高温高湿预处理系统、湿度粉尘过滤器多个、挂绳、光盘（上位机通讯软件）



## 四、外型图



## 五、按键定义及操作说明

**返回键：ESC 键。**菜单选择时，返回上一级菜单；报警消音状态下按此键消音。

**菜单键：MENU 键。**进入、退出菜单，报警的时候按一下起消音作用，消音以后，显示屏右上方出现消音图标，按一下返回键（ESC）键取消消音状态。


① **键：**电源键、确认键。长按 5 秒钟开机，开机以后长按 5 秒钟关机，

《《 **键：**方向键，左移光标，修改数字时起移位的作用。

》》 **键：**方向键，右移光标，修改数值时调整数值大小和翻页的作用。

## 六、开机启动说明

开机显示公司信息开机自检及传感器预热需要的倒计时时间，如图片 1、图片 2：

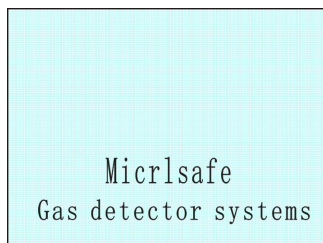


图片 1



图片 2

开机显示本台设备的地址编号及软件版本，如图片 3：

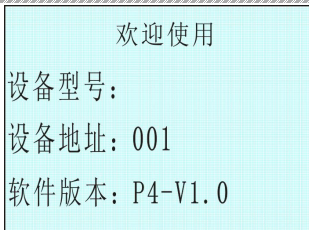

图片 3

倒计时完以后进入测试界面，如图片 4：



图片 4

按确认键“① 键”可切换不同的显示模式，按》》 键切换通道。

各种模式都有图片指示（图片与实际产品有偏差，建议图片参考实物），

如图片 5、图片 6、图片 7 图片 8：



图片 5



图片 6



图片 7



图片 8

## 七、菜单操作说明

### 7.1 零点校准操作说明

当传感器出现零点漂移过大，或者需要精确检测很低浓度的时候才进行零点校准操作。

在测试界面按“MENU”键进入菜单，通过“《《”键和“》》”键选择到“零点校准”菜单，按“①”键进入零点校准界面，如图片 9：



图片 9

## SFD-100MJ 系列便携式可燃/有毒气体检测仪 产品说明书

选择要校准的通道，按“①”键进行零点校准，校准成功以后显示：

“校准成功”字样，如图片 10、图片 11、图片 12：



零点校准		
通道	浓度值	状态
CO	0.5	校准
H <sub>2</sub> S	0.00	校准
O <sub>2</sub>	20.90	校准
CO <sub>2</sub>	420	校准

图片 10



零点校准		
通道	浓度值	状态
CO	0.5	进入校准
H <sub>2</sub> S	0.00	进入校准
O <sub>2</sub>	20.90	进入校准
CO <sub>2</sub>	420	进入校准

图片 11



零点校准		
通道	浓度值	状态
CO	0.0	校准成功
H <sub>2</sub> S	0.00	校准
O <sub>2</sub>	20.90	校准
CO <sub>2</sub>	420	校准

图片 12

CO<sub>2</sub> 在空气中校准成功以后就显示 400ppm 左右，如图片 13：



零点校准		
通道	浓度值	状态
CO	0.0	校准成功
H <sub>2</sub> S	0.00	校准成功
O <sub>2</sub>	20.90	校准成功
CO <sub>2</sub>	400	校准成功

图片 13

如果校准不成功就显示：“校准失败”字样 O<sub>2</sub> 或 N<sub>2</sub> 在空气中校准零点就会失败，如图片 14：



零点校准		
通道	浓度值	状态
CO	0.0	校准成功
H <sub>2</sub> S	0.00	校准成功
O <sub>2</sub>	20.90	校准失败
CO <sub>2</sub>	420	校准

图片 14

## 7.2 浓度校准操作说明

仪器检测到的浓度与标准气体浓度有偏差可以通过浓度校准或改变显示系数来修正。

在测试界面按一下“MENU”键进入菜单，通过“《《”键和“》》”键选择到“浓度校准”菜单，如图片 15：



图片 15

再按“①”键进入浓度校准界面，如图片 16：



图片 16

光标默认出现在一级浓度的位置，按“①”键进入浓度值设置，“《《”键选择位置，“》》”键修改数值，修改完以后按“①”键保存。（备注：修改值必须校准成功后有效，否则下次进入菜单，则恢复到以前浓度值），如图片 17：



图片 17

通入标准气体或被测气体，将光标移到“校准”位置，再按“①”键校准，如果成功则出现“成功”字样，如果不成功则出现“失败”字样，如图片 18、图片 19、图片 20：



图片 18



图片 19



图片 20

### 校准注意事项：

通常只需校准一级浓度即可以满足精度要求。预先设置要校准的浓度值或标准气体的浓度值，再通入 500 毫升/分钟的被测气体 30 秒后进行校准。

### 三级校准浓度值设置规则：

一级浓度值 < 二级浓度值 < 三级浓度值。

### 三级浓度校准顺序：

一级浓度校准→二级浓度校准→三级浓度校准。

## 7.3 恢复出厂操作说明

在测试界面按一下“MENU”键进入菜单，通过“《《”键和“》》”键选择到“恢复出厂”菜单，按“①”键进入恢复出厂界面，如图片 21、

图片 21



图片 21



图片 22

选择要恢复的通道，再按“①”键进入可选选择“恢复浓度”、“恢复报警”、“全部恢复”，再按“①”键进行恢复，如果恢复成功就会出现“成功”字样，不成功就会出现“失败”字样，如图片 23、图片 24、图片 25：



图片 23



图片 24



图片 25



当设置错误或测试浓度不准确时需要进行恢复出厂的操作，如果是人为因素造成的不良可以得到恢复，可以恢复出厂的参数：零点校准值、浓度校准值、报警值、报警方式、报警模式、最大量程等。

## 7.4 数据记录操作说明

在测试界面按一下“MENU”键进入菜单，通过“《《”键和“》》”键选择到“数据记录”菜单，按“①”键进入数据记录界面：如图片 26：



图片 26


按“①”键选择要查询记录的通道，使用“《《”键和“》》”，“①”键修改开始时间和结束时间，如图片 27、图片 28、图片 29：



图片 27




图片 28



图片 29

按“①”键选择“全部数据”或“报警数据”。

选择“开始查询”，按“①”键查询，按“《《”键、“》》”翻页浏览，如图片 30、图片 31：

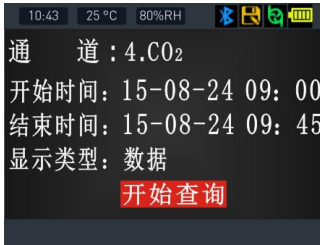

图片 30



图片 31

如果查询无记录，如图片 32：




图片 32

请前往“系统设置”→“存储设置”确认存储功能是否开启。选择“定时存储”即实时存储功能并设置存储周期（时间间隔）。

如图，按以下步骤开启，如图片 33、图片 34、图片 35、图片 36、图片 37、图片 38：



图片 33




图片 34



图片 35



图片 36



图片 37



图片 38

## 7.5 报警设置操作说明

在测试界面按一下“MENU”键进入菜单，通过“《《”键和“》》”键选择到“报警设置”菜单，按“①”键进入报警设置界面通过“《《”键和“》》”键选择“报警数值”，“报警参数”，“报警模式”，按“①”键进入，如图片 39、40：



图片 39



图片 40

**报警数值设置**，如图片 41、图片 42、图:43:

可以通过“①”键和“《《”键和“》》”键修改高/低限值。

低限值：即一级报警值，可修改；高限值：即二级报警值，可修改。

报警数值			
通道	低限值	高限值	备注信息
CO	0050.0	0200.0	暂无
H <sub>2</sub> S	020.00	050.00	暂无
O <sub>2</sub>	018.00	023.00	暂无
CO <sub>2</sub>	01000	02000	暂无

图片 41

报警数值			
通道	低限值	高限值	备注信息
CO	0050.0	0200.0	暂无
H <sub>2</sub> S	020.00	050.00	暂无
O <sub>2</sub>	018.00	023.00	暂无
CO <sub>2</sub>	01000	02000	暂无

图片 42

报警数值			
通道	低限值	高限值	备注信息
CO	0050.0	0200.0	暂无
H <sub>2</sub> S	020.00	050.00	暂无
O <sub>2</sub>	018.00	023.00	暂无
CO <sub>2</sub>	01000	02000	暂无

图片 43

**报警参数设置**，如图片 44:



图片 44

“《《”键和“》》”键切换光标，“①”键选择参数。

**报警方式**：按“①”键选择可选声光、振动、声光+振动、无报警如图片

45:



图片 45

**报警声音：**3种声音可选，如图片46：



图片 46

**报警回差：**即报警回程差，可设置每一通道的报警回差值，如果设置为0，只要数值达到报警设定值就马上报警，若不想数值在报警设定值的临界点发生频繁报警，可以把报警回差设置一定的数值，通过“①”键和“《《”键和“》》”键修改，如图片47：



图片 47

**报警模式：**一般不需要设置，已默认设置好。

O<sub>2</sub> 和 N<sub>2</sub> 默认设置为 <AL>AH 报警，

其它气体默认设置为 >AL<>AH 报警，

可以修改或设置为“关闭报警”（备注，若选择关闭报警，则测量浓度值高于报警值时，将不产生报警），如图片48、图片49：



图片 48



图片 49

## 7.6 系统设置操作说明

在测试界面按一下“MENU”键进入菜单，通过“《《》”键和“》》”键选择到“系统设置”菜单，按“①”键进入系统设置界面，如图片 50：



图片 50

**量程设置：**显示的是各个气体的最大检测范围，出厂时已设定好，若要修改，请致电厂家确认是否可以修改，某传感器过载测量会损坏传感器。

如图片 51、图片 52：



图片 51



图片 52

**时间设置：**修改日期和时间，按“①”键以后，通过“《《”键和“》》”键选择和修改，再按“①”键保存，如图片 53、图片 54：



图片 53



图片 54

**背景设置：**根据个人的喜好，修改字体的颜色、背景颜色、背光休眠时间，也可以选择“恢复默认”恢复默认的设置。

通过“《《”键和“》》”键选择和修改，再按“①”键保存，如图片 55、图片 56、图片 57：



图片 55



图片 56



图片 57

**存储设置：**将光标移到“存储设置”按“①”键进入设置界面。

**存储方式：**可设置定时存储、报警触发两种模式，“定时存储”是在每个存储周期时间内存储数据一次，如图片 58：




图片 58

“报警触发”存储方式是只存储报警的数据，只有当浓度值达到报警设定值的时候才开始存储，不报警就不存储，如图片 59：



图片 59

**存储周期：**存储数据的时间间隔，1-9999 秒可设，如图片 60：

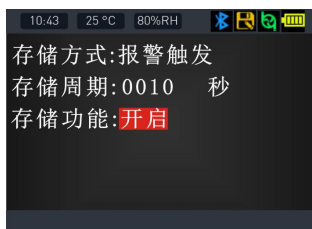

图片 60

**存储功能：**选择开启或关闭数据存储功能，如图片 61：





图片 61

**通讯设置：**不连电脑或数据传输时无需设置，如图片 62：



图片 62

**设备地址：**本机的地址编号，可设 1-255。

**通讯接口：**自动识别通讯的方式。

**波特率：**通讯速率，一般选 9600。

如图片 63：



图片 63

## 7.7 单位设置操作说明

在测试界面按一下“MENU”键进入菜单，通过“《《”键和“》》”键选择到第二页“单位设置”菜单，按“①”键进入设置界面，如图片 64：



图片 64

各单位之间自动换算，可以切换的单位，如图片 65、图片 66：

ppm、Vol%、LEL%、ppb、pphm、mg/m<sup>3</sup>、mg/L、g/m<sup>3</sup>

单位设置		
通道	分子量	单位
CO	28	ppm
H <sub>2</sub> S	34	ppm
O <sub>2</sub>	32	%VOL
CO <sub>2</sub>	44	ppm

图片 65

单位设置		
通道	分子量	单位
CO	28	ppm
H <sub>2</sub> S	34	ppm
O <sub>2</sub>	32	mg/m <sup>3</sup>
CO <sub>2</sub>	44	ppm

图片 66

## 7.8 其它设置操作说明

在测试界面按一下“MENU”键进入菜单，通过“《《》”键和“》》”键选择到第二页“其它设置”菜单，按“①”键进入设置界面，如图片 67：



图片 67

预热时间：传感器需要的预热稳定时间，不建议修改，如图片 68：



图片 68

语言选择：默认中文，可选英文，如图片 69：



图片 69

气体名称：默认显示气体的名称分子式，如图片 70：




图片 70

显示最大值：选择打开就在单通道界面显示本次测量的最大值和上次测量的最大值。

显示最小值：选择打开就在单通道界面显示本次测量的最小值和上次测量的最小值。

如图片 71：

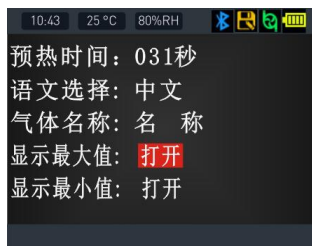

图片 71

## 7.9 本机信息说明

在测试界面按一下“MENU”键进入菜单，通过“《《》”键和“》》”键选择到第二页“本机信息”菜单，按“①”键进入查看界面，如图片 72：




图片 72

设备信息：可查看本台设备的相关信息，如图片 73、图片 74：



图片 73

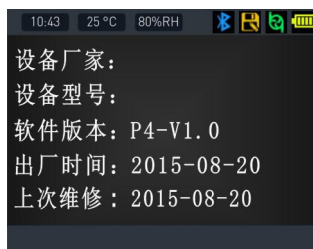

图片 74

传感器信息：可查看本台设备上的传感器的寿命及使用年限，避免超期使用影响准确性和可靠性，如图片 75、图片 76：




图片 75



图片 76

维修记录：记录本台设备的维修信息，如图片 77、图片 78：

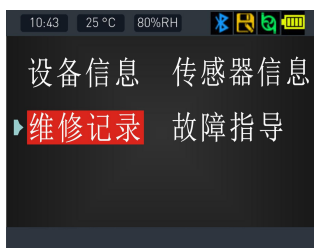


图片 77



图片 78

故障指导：介绍简单的故障处理方法目前暂无法查看，如图片 79：

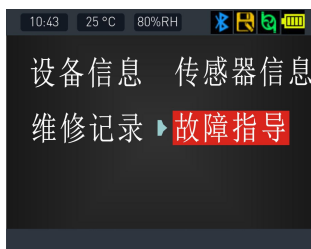

图片 79

## 八、常见故障及解决对策

### 故障 1：低浓度的时候检测不出来

解决对策：

- 1、检查泵是否工作，泵正常工作的时候有轻微的振动，并且用手指堵住进气口 2 秒钟可以感觉到有明显的吸力。然后再检查过滤器的进气口是

否被堵塞或连接处没有密封好导致漏气而无吸力。

- 2、通入氮气校准零点或在洁净空气中校准零点，校准完以后马上进行检测。
- 3、校准零点以后还检测不出被测气体，需要进行恢复出厂设置操作。
- 4、恢复出厂设置以后还检测不出来，需要再次通入氮气或在洁净空气中进行零点校准操作，校准完以后马上进行检测。
- 5、检查传感器的连接线有没有被人为损坏或接触不良。
- 6、以上四个步骤都做了还是检测不出来，需要确认一下现场是否存在被测气体，或者被测气体的浓度确实很低，如果低于仪器的最小检出限值就无法检测。

## **故障 2：在空气中，没有被测气体，但是数值波动很大或乱跳**

解决对策：

- 1、一般短时间零点波动范围小于最大量程的 1%属于正常范围，在没有被测气体的情况下长时间漂移小于最大量程的 2%属于正常范围，若超出此范围，需要确认现场是否存在被测气体，或空气中的温度和湿度波动较大，导致数值不稳，一般情况下温度和湿度波动大会造成仪器检测数值短时间波动较大，待空气中的温度和湿度恒定以后，数值也会相对比较稳定。
- 2、确认是否对仪器进行了零点校准或目标点校准操作，若在有被测气体的场合进行了零点校准操作就可能检测不出低浓度的气体，若在有被测

气体的场合进行了目标点校准，但是校准的浓度值和实际浓度值不符，可能造成仪器数值波动很大或检测到的数值偏小，这 2 种情况都进行恢复出厂操作就可以解决。

3、如果还无法解决问题，需要确认是否通入了高浓度的气体或有高浓度的气体冲击了传感器，如果有冲击过传感器，将仪器上电老化 24 小时以后，数值还不稳就可能是传感器被冲击坏了。

### **故障 3：检测不准确**

解决对策：

1、确认现场的气体浓度是否准确，有时候理论值和实际值之间的差值很大，最好通过通入标准气体来验证仪器的准确性，或送第三方计量机构检测。

2、若传感器使用的时间较长，测量值可能会有一些误差，需要先和厂家确认传感器是否还可以再继续使用，若传感器本身已经快接近使用寿命了，即使标定完当时可以正常使用，但是过不了多久又不能正常使用了，建议更换传感器。

### **故障 4：数值为 0 的时候或在空气中没有达到报警值也报警**

解决对策：

1、检查报警值是否被修改了。

2、检查报警方式、报警模式是否被修改了。



3、检查报警状态是浓度报警还是故障报警，浓度报警会出现 AL 或 AH 字样，并且红色指示灯会闪烁，故障报警会亮黄色灯。

4、如果是人为修改导致的报警可以通过恢复出厂设置来解决，故障报警需要进一步检查是否短路、断路，接触不良，传感器故障等，或寄回厂家检查。

### 故障 5: 无法和电脑通讯

解决对策:

1、检查设备地址，通讯软件里设置的地址必须和仪器的设备地址一致。

2、在电脑的 硬件-设备管理器-端口 检查 RS485/RS232 转换器对应的串口是否连接上。对于 USB 接口的设备，也是要检测串口是否连上，端口号是否正确。

## 九、设备维护

检测仪在正常的使用中，大部分传感器的有效使用寿命为 24-36 个月。在有效使用寿命期内，每 6 个月或 1 年要定期对传感器进行一次标定检查，以保证气体检测功能的准确有效。超过有效使用期的和有故障的传感器必须进行更换。

## 9.1 传感器更换

在传感器出现故障后，请将仪器寄回厂家更换并重新校准。

## 9.2 传感器标定

详见第 7 章节 7.1 和 7.2 细节描述。在标准气体未准备好时请勿操作。当误操作时需要通过第 7.3 章节的操作来恢复出厂设置。

# 十、注意事项

- 充电器必须使用原配充电器，若使用其他厂家提供的充电器，规格为 4.2V, 2A 或 5V, 2A，不能大于 5V, 2A，也不能小于 4.2V, 1A。
- 严禁带电更换传感器。
- 进行传感器标定，通入氮气或标准气体时，从气瓶里出来的气体不能用软管直接连到仪器，必须接入一个三通分流器，在保证通气量大于等于 500 毫升/分钟的同时，多余的气体能从三通的旁路排走，避免传感器的气室内部压力大于正常值。
- 安装、调试、设置等操作必须由专业人员进行。
- 检测仪的标定检查要定期进行超过有效使用期和有故障的传感器要及时更换。
- 避免用高于测量量程的气体冲击传感器。
- 发生故障、异常、检测不准确时，请进行恢复出厂设置操作，

通常可以解决问题，若问题还是无法解决，请与厂家联系。

- 发生故障、异常、检测不准确时，请进行恢复出厂设置操作，通常可以解决问题，若问题还是无法解决，请与厂家联系。

## 十一、其它可选配的传感器技术性能及参数表

选配：1~4 种气体任意组合

检测气体	量程	最大允许 误差值	最小读数	响应时 间 T90
可燃气体 (E <sub>x</sub> )	0-100%LEL	< ±3% (F. S)	0.1%LEL	≤10 秒
可燃气体 (E <sub>x</sub> )	0-100%Vol	< ±3% (F. S)	0.1%Vol	≤10 秒
甲烷 (CH <sub>4</sub> )	0-100%LEL	< ±3% (F. S)	0.1%LEL	≤10 秒
甲烷 (CH <sub>4</sub> )	0-100%Vol	< ±3% (F. S)	0.1%Vol	≤10 秒
氧气 (O <sub>2</sub> )	0-30%Vol	< ±3% (F. S)	0.01%Vol	≤10 秒
氧气 (O <sub>2</sub> )	0-100%Vol	< ±3% (F. S)	0.01%Vol	≤10 秒
氧气 (O <sub>2</sub> )	0-5000ppm	< ±3% (F. S)	1ppm	≤30 秒
氮气 (N <sub>2</sub> )	0-100%Vol	< ±3% (F. S)	0.01%Vol	≤10 秒
一氧化碳 (CO)	0-100ppm	< ±3% (F. S)	0.1ppm	≤25 秒
一氧化碳 (CO)	0-1000ppm	< ±3% (F. S)	0.1ppm	≤25 秒
一氧化碳 (CO)	0-2000ppm	< ±3% (F. S)	0.1ppm	≤25 秒
一氧化碳 (CO)	0-20000ppm	< ±3% (F. S)	1ppm	≤25 秒
一氧化碳 (CO)	0-100000ppm	< ±3% (F. S)	1ppm	≤25 秒
二氧化碳 (CO <sub>2</sub> )	0-500ppm	< ±3% (F. S)	1ppm	≤20 秒
二氧化碳 (CO <sub>2</sub> )	0-2000ppm	< ±3% (F. S)	1ppm	≤20 秒

## SFD-100MJ 系列便携式可燃/有毒气体检测仪产品说明书

二氧化碳 (CO <sub>2</sub> )	0-5000ppm	< ±3% (F. S)	1ppm	≤20 秒
二氧化碳 (CO <sub>2</sub> )	0-50000ppm	< ±3% (F. S)	1ppm	≤30 秒
二氧化碳 (CO <sub>2</sub> )	0-20%Vol	< ±3% (F. S)	0.01%Vol	≤30 秒
二氧化碳 (CO <sub>2</sub> )	0-100%Vol	< ±3% (F. S)	0.01%Vol	≤30 秒
甲醛 (CH <sub>2</sub> O)	0-10ppm	< ±3% (F. S)	0.001ppm	≤30 秒
甲醛 (CH <sub>2</sub> O)	0-10ppm	< ±3% (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
甲醛 (CH <sub>2</sub> O)	0-100ppm	< ±3% (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
甲醛 (CH <sub>2</sub> O)	0-5000ppm	< ±3% (F. S)	1ppm	≤50 秒
臭氧 (O <sub>3</sub> )	0-1ppm	< ±3% (F. S)	0.001ppm	≤20 秒
臭氧 (O <sub>3</sub> )	0-5ppm	< ±3% (F. S)	0.001ppm	≤20 秒
臭氧 (O <sub>3</sub> )	0-50ppm	< ±3% (F. S)	0.01ppm	≤20 秒
臭氧 (O <sub>3</sub> )	0-100ppm	< ±3% (F. S)	0.01ppm	≤20 秒
臭氧 (O <sub>3</sub> )	0-2000ppm	< ±3% (F. S)	0.1ppm	≤30 秒
臭氧 (O <sub>3</sub> )	0-30000ppm	< ±3% (F. S)	1ppm	≤30 秒
臭氧 (O <sub>3</sub> )	0-20mg/L	< ±3% (F. S)	0.01mg/L	≤30 秒
臭氧水 (O <sub>3</sub> )	0-20mg/L	< ±3% (F. S)	0.01mg/L	≤30 秒
硫化氢 (H <sub>2</sub> S)	0-10ppm	< ±3% (F. S)	0.001ppm	≤30 秒
硫化氢 (H <sub>2</sub> S)	0-50ppm	< ±3% (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
硫化氢 (H <sub>2</sub> S)	0-100ppm	< ±3% (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
硫化氢 (H <sub>2</sub> S)	0-2000ppm	< ±3% (F. S)	0.1ppm	≤30 秒
硫化氢 (H <sub>2</sub> S)	0-10000ppm	< ±3% (F. S)	1ppm	≤45 秒
二氧化硫 (SO <sub>2</sub> )	0-10ppm	< ±3% (F. S)	0.001ppm	≤30 秒
二氧化硫 (SO <sub>2</sub> )	0-20ppm	< ±3% (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
二氧化硫 (SO <sub>2</sub> )	0-100ppm	< ±3% (F. S)	0.01ppm	≤30 秒

## SFD-100MJ 系列便携式可燃/有毒气体检测仪 产品说明书

二氧化硫 (SO <sub>2</sub> )	0-500ppm	< ±3% (F. S)	0. 1ppm	≤30 秒
二氧化硫 (SO <sub>2</sub> )	0-2000ppm	< ±3% (F. S)	0. 1ppm	≤30 秒
二氧化硫 (SO <sub>2</sub> )	0-10000ppm	< ±3% (F. S)	1ppm	≤30 秒
一氧化氮 (NO)	0-10ppm	< ±3% (F. S)	0. 001ppm	≤30 秒
一氧化氮 (NO)	0-100ppm	< ±3% (F. S)	0. 01ppm	≤30 秒
一氧化氮 (NO)	0-2000ppm	< ±3% (F. S)	0. 1ppm	≤30 秒
一氧化氮 (NO)	0-5000ppm	< ±3% (F. S)	1ppm	≤30 秒
二氧化氮 (NO <sub>2</sub> )	0-10ppm	< ±3% (F. S)	0. 001ppm	≤25 秒
二氧化氮 (NO <sub>2</sub> )	0-100ppm	< ±3% (F. S)	0. 01ppm	≤25 秒
二氧化氮 (NO <sub>2</sub> )	0-1000ppm	< ±3% (F. S)	0. 1ppm	≤30 秒
二氧化氮 (NO <sub>2</sub> )	0-5000ppm	< ±3% (F. S)	1ppm	≤30 秒
氮氧化物 (NO <sub>x</sub> )	0-10ppm	< ±3% (F. S)	0. 001ppm	≤30 秒
氮氧化物 (NO <sub>x</sub> )	0-100ppm	< ±3% (F. S)	0. 01ppm	≤30 秒
氮氧化物 (NO <sub>x</sub> )	0-2000ppm	< ±3% (F. S)	0. 1ppm	≤30 秒
氮氧化物 (NO <sub>x</sub> )	0-5000ppm	< ±3% (F. S)	1ppm	≤30 秒
氯气 (CL <sub>2</sub> )	0-10ppm	< ±3% (F. S)	0. 001ppm	≤30 秒
氯气 (CL <sub>2</sub> )	0-20ppm	< ±3% (F. S)	0. 01ppm	≤30 秒
氯气 (CL <sub>2</sub> )	0-200ppm	< ±3% (F. S)	0. 1ppm	≤30 秒
氯气 (CL <sub>2</sub> )	0-2000ppm	< ±3% (F. S)	0. 1ppm	≤30 秒
氨气 (NH <sub>3</sub> )	0-50ppm	< ±3% (F. S)	0. 01ppm	≤30 秒
氨气 (NH <sub>3</sub> )	0-100ppm	< ±3% (F. S)	0. 01ppm	≤30 秒
氨气 (NH <sub>3</sub> )	0-1000ppm	< ±3% (F. S)	0. 1ppm	≤30 秒
氨气 (NH <sub>3</sub> )	0-5000ppm	< ±3% (F. S)	1ppm	≤30 秒

## SFD-100MJ 系列便携式可燃/有毒气体检测仪产品说明书

氨气 ( NH <sub>3</sub> )	0-100%LEL	< ± 3% (F. S)	0. 1%LEL	≤ 10 秒
氢气 ( H <sub>2</sub> )	0-100%LEL	< ± 3% (F. S)	0. 1%LEL	≤ 10 秒
氢气 ( H <sub>2</sub> )	0-1000ppm	< ± 3% (F. S)	0. 1ppm	≤ 30 秒
氢气 ( H <sub>2</sub> )	0-20000ppm	< ± 3% (F. S)	1ppm	≤ 30 秒
氢气 ( H <sub>2</sub> )	0-40000ppm	< ± 3% (F. S)	1ppm	≤ 30 秒
氢气 ( H <sub>2</sub> )	0-100%Vol	< ± 3% (F. S)	0. 01%Vol	≤ 20 秒
氦气 ( He )	0-100%Vol	< ± 3% (F. S)	0. 01%Vol	≤ 20 秒
氩气 ( Ar )	0-100%Vol	< ± 3% (F. S)	0. 01%Vol	≤ 20 秒
氙气 ( Xe )	0-100%Vol	< ± 3% (F. S)	0. 01%Vol	≤ 20 秒
氰化氢 ( HCN )	0-30ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤ 30 秒
氰化氢 ( HCN )	0-100ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤ 30 秒
氯化氢 ( HCL )	0-20ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤ 30 秒
氯化氢 ( HCL )	0-200ppm	< ± 3% (F. S)	0. 1ppm	≤ 30 秒
磷化氢 ( PH <sub>3</sub> )	0-5 ppm	< ± 3% (F. S)	0. 001ppm	≤ 30 秒
磷化氢 ( PH <sub>3</sub> )	0-25 ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤ 30 秒
磷化氢 ( PH <sub>3</sub> )	0-2000 ppm	< ± 3% (F. S)	1ppm	≤ 30 秒
二氧化氯 ( CL O <sub>2</sub> )	0-1ppm	< ± 3% (F. S)	0. 001ppm	≤ 30 秒
二氧化氯 ( CL O <sub>2</sub> )	0-10ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤ 30 秒
二氧化氯 ( CL O <sub>2</sub> )	0-200ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤ 30 秒
环氧乙烷 ( ETO )	0-100ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤ 30 秒
环氧乙烷 ( ETO )	0-1000ppm	< ± 3% (F. S)	0. 1ppm	≤ 30 秒
环氧乙烷 ( ETO )	0-100%LEL	< ± 3% (F. S)	1%LEL	≤ 30 秒
光气 ( COCL <sub>2</sub> )	0-1ppm	< ± 3% (F. S)	0. 001ppm	≤ 20 秒

## SFD-100MJ 系列便携式可燃/有毒气体检测仪 产品说明书

光气 ( COCL <sub>2</sub> )	0-50ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤ 20 秒
硅烷 ( SiH <sub>4</sub> )	0-1ppm	< ± 3% (F. S)	0. 001ppm	≤ 30 秒
硅烷 ( SiH <sub>4</sub> )	0-50ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤ 30 秒
氟气 ( F <sub>2</sub> )	0-1ppm	< ± 3% (F. S)	0. 001ppm	≤ 30 秒
氟气 ( F <sub>2</sub> )	0-10ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤ 30 秒
氟气 ( F <sub>2</sub> )	0-50ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤ 30 秒
氟化氢 ( HF )	0-10ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤ 30 秒
氟化氢 ( HF )	0-50ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤ 30 秒
溴化氢 ( HBr )	0-50ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤ 30 秒
乙硼烷 ( B <sub>2</sub> H <sub>6</sub> )	0-10ppm	< ± 3% (F. S)	0. 001ppm	≤ 30 秒
砷化氢 ( AsH <sub>3</sub> )	0-1ppm	< ± 3% (F. S)	0. 001ppm	≤ 30 秒
砷化氢 ( AsH <sub>3</sub> )	0-10ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤ 30 秒
砷化氢 ( AsH <sub>3</sub> )	0-50ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤ 30 秒
锗烷 ( GeH <sub>4</sub> )	0-2ppm	< ± 3% (F. S)	0. 001ppm	≤ 30 秒
锗烷 ( GeH <sub>4</sub> )	0-20ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤ 30 秒
肼, 联氨 ( N <sub>2</sub> H <sub>4</sub> )	0-1ppm	< ± 3% (F. S)	0. 001ppm	≤ 30 秒
肼, 联氨 ( N <sub>2</sub> H <sub>4</sub> )	0-300ppm	< ± 3% (F. S)	0. 1ppm	≤ 30 秒
四氢噻吩 ( THT )	0-100mg/m <sup>3</sup>	< ± 3% (F. S)	0. 01 mg/m <sup>3</sup>	≤ 60 秒
溴气 ( Br <sub>2</sub> )	0-10ppm	< ± 3% (F. S)	0. 001ppm	≤ 30 秒
溴气 ( Br <sub>2</sub> )	0-100ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤ 30 秒
溴气 ( Br <sub>2</sub> )	0-2000ppm	< ± 3% (F. S)	1ppm	≤ 30 秒
乙炔 ( C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> )	0-100%LEL	< ± 3% (F. S)	0. 1%LEL	≤ 30 秒
乙炔 ( C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> )	0-100ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤ 30 秒

## SFD-100MJ 系列便携式可燃/有毒气体检测仪产品说明书

乙炔 ( C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> )	0-1000ppm	< ± 3% (F. S)	0. 1ppm	≤ 30 秒
乙烯 ( C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> )	0-100%LEL	< ± 3% (F. S)	0. 1%LEL	≤ 30 秒
乙烯 ( C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> )	0-100ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤ 30 秒
乙烯 ( C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> )	0-2000ppm	< ± 3% (F. S)	0. 1ppm	≤ 30 秒
乙醛	0-10ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤ 30 秒
乙醇 ( C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O )	0-100ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤ 30 秒
乙醇 ( C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O )	0-2000ppm	< ± 3% (F. S)	1ppm	≤ 30 秒
甲醇 ( CH <sub>3</sub> O )	0-100ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤ 30 秒
甲醇 ( CH <sub>3</sub> O )	0-2000ppm	< ± 3% (F. S)	1ppm	≤ 30 秒
二硫化碳 ( CS <sub>2</sub> )	0-50ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤ 30 秒
二硫化碳 ( CS <sub>2</sub> )	0-5000ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤ 30 秒
丙烯腈 ( C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> N )	0-50ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤ 30 秒
丙烯腈 ( C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> N )	0-2000ppm	< ± 3% (F. S)	1ppm	≤ 30 秒
甲胺 ( CH <sub>3</sub> N )	0-50ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤ 30 秒
典气 ( I <sub>2</sub> )	0-50ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤ 30 秒
苯乙烯 ( C <sub>8</sub> H <sub>8</sub> )	0-200ppm	< ± 3% (F. S)	0. 1ppm	≤ 30 秒
苯乙烯 ( C <sub>8</sub> H <sub>8</sub> )	0-5000ppm	< ± 3% (F. S)	1ppm	≤ 30 秒
氯乙烯 ( C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> CL )	0-100ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤ 30 秒
三氯乙烯 ( C <sub>2</sub> HCL <sub>3</sub> )	0-100ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤ 30 秒
四氯乙烯 ( C <sub>2</sub> CL <sub>4</sub> )	0-100ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤ 30 秒
笑气 ( N <sub>2</sub> O )	0-100ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤ 30 秒
三氟化氮 ( NF <sub>3</sub> )	0-100ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤ 30 秒
过氧化氢 ( H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )	0-100ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤ 30 秒



## SFD-100MJ 系列便携式可燃/有毒气体检测仪 产品说明书

溴甲烷 ( CH <sub>3</sub> Br )	0-100ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤30 秒
溴甲烷 ( CH <sub>3</sub> Br )	0-30000ppm	< ± 3% (F. S)	1ppm	≤30 秒
溴甲烷 ( CH <sub>3</sub> Br )	0-200g/m <sup>3</sup>	< ± 3% (F. S)	0. 1g/m <sup>3</sup>	≤30 秒
硫酰氟 ( SO <sub>2</sub> F <sub>2</sub> )	0-100ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤30 秒
硫酰氟 ( SO <sub>2</sub> F <sub>2</sub> )	0-5000ppm	< ± 3% (F. S)	1ppm	≤30 秒
硫酰氟 ( SO <sub>2</sub> F <sub>2</sub> )	0-10000ppm	< ± 3% (F. S)	1ppm	≤30 秒
苯 ( C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> )	0-10ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤30 秒
苯 ( C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> )	0-100ppm	< ± 3% (F. S)	0. 01ppm	≤30 秒
苯 ( C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> )	0-2000ppm	< ± 3% (F. S)	1ppm	≤30 秒

注：其它未在上表列出的气体以及其他检测量程可来电咨询。



深圳市索福达电子有限公司  
深圳市索安达科技有限公司

地址：深圳市南山区高新区中区琼宇路8号全科工业大厦北座七层

邮编：518057

电话：0755-2673 4055 2673 8439 2673 8321

免费服务电话：400 688 6872

传真：0755-2673 4003

邮箱：suofuda800@163.com

网址：www.suofuda.com



粤制 00000719